SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Toise pédiatrique Seca 207, réf. 1458

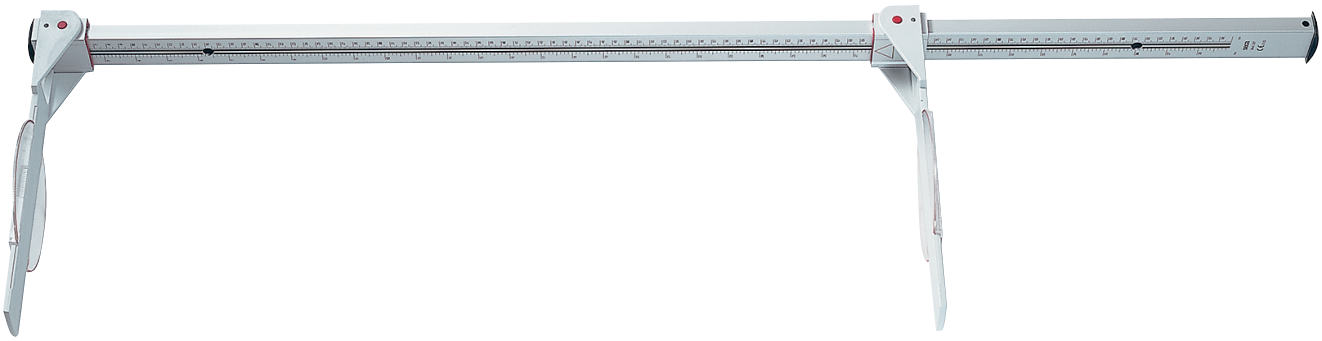

Description

- La toise de mesure pédiatrique Seca 207 est un appareil de mesure pour les nourrissons à la fois précis et robuste.
- La toise de mesure permet tant de mesurer la taille d'un nouveau-né à la naissance que de la contrôler au cours de la croissance.
- Elle est fabriquée en profilé aluminium rigide et ne requiert aucun entretien.
- Les languettes de mesure coulissantes en plastique peuvent être rabattues pour permettre un rangement pratique de la règle graduée.
- Des vis et une pièce d'écartement fournies permettent de fixer la règle au mur.
- La règle graduée peut ainsi être installée verticalement au-dessus d'une table de soins pour faire office de dispositif de mesure fixe.
- La règle graduée seca 207 est destinée principalement aux hôpitaux et cabinets médicaux.

Caractéristiques techniques

- **Matériau :** - Profilé : construction stable en aluminium ;
  - Languettes coulissantes : en plastique.
- **Dimensions :** - Déployée : H 1047 x L 120 x P 286 mm ;
  - Replié : H 1047 x L 120 x P 30 mm.
- **Poids :** 0.81 kg.
- **Résistance :** cadran résistant à l'abrasion.
- **Plage de mesure :** de 0 à 99 cm.
- **Graduation :** 1 mm.
- **Précision :** supérieure à plus ou moins 10 mm.
- **Température d'utilisation :** de 10°C à 40°C.
- **Fixation :** sur table à langer ou mural possible (vis et une pièce d'écartement fournies).
- **Entretien :** nettoyer la toise de mesure si nécessaire avec un nettoyant ménager ou un désinfectant courant. Veiller à respecter les instructions du fabricant.
- **Elimination :** si la toise de mesure ne peut plus être utilisée, l'organisme d'enlèvement des déchets pourra renseigner sur les mesures nécessaires à prendre pour une élimination appropriée.
- **Conformité :** produit médical en vertu de la directive 93/42/CEE : Classe I avec fonction de mesure.

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser la nouvelle toise de mesure, prendre le temps de lire les consignes de sécurité.
- Veiller à respecter les instructions du mode d'emploi.
- Ne jamais laisser le nourrisson sans surveillance sur la toise de mesure afin d'éviter tout danger.
- N'effectuer la mesure que sur des surfaces desquelles le nourrisson ne peut tomber.
- Veiller à ce que la toise de mesure et le pèse-bébé soient régulièrement nettoyés et désinfectés, afin d'éviter toute transmission de maladie contagieuse.
- Pour effectuer la mesure exacte de la taille, l'aide d'une deuxième personne est recommandée.

Mode d'emploi
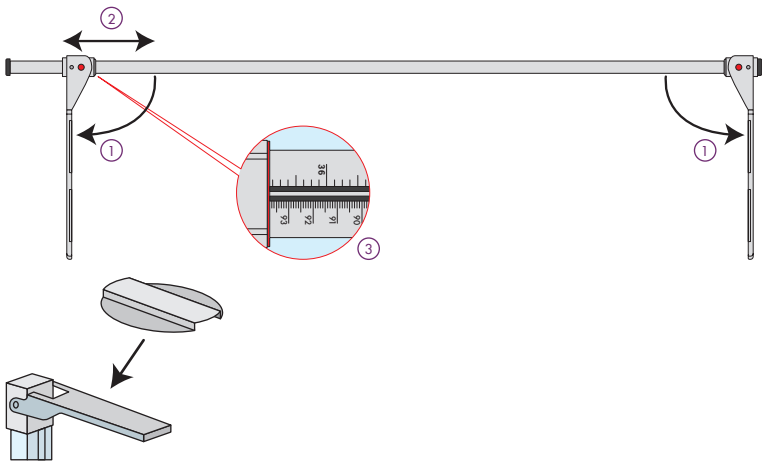
- Poser le nourrisson sur une surface plane et poser la toise en poussant le curseur (**1**) sur la tête du nourrisson.
- Avec la main droite, faire glisser le curseur (**2**) en direction des pieds du nourrisson.
- Maintenir le nourrisson en place avec la main gauche.
- Tendre les jambes en poussant délicatement sur les genoux du nourrisson avec la main gauche.
- Avec la main droite, pousser le curseur (**2**) contre la plante des pieds du nourrisson.
- Lire la taille sur la graduation sur le côté interne de la toise de mesure (**3**).
- En respectant les étapes ci-dessus, on obtient une précision de mesure d'environ 10 mm plus ou moins.
- **Fixer la rallonge de languette métrique :** appuyer la rallonge à partir du haut sur la languette métrique jusqu'au déclic. La rallonge se déplace sans effort sur la languette métrique.